

Iniciales del paciente: \_\_\_\_\_ Ortopedia: \_\_\_\_\_

Técnico: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Tipo de Férula\*: \_\_\_\_\_ \*Códigos por detrás\*

Entrada de datos


Escaneo  
  Medidas  
  Molde Escayola  
  Molde Fibra

Material

PLA  
  TP  
  HT

Grosos EVA: \_\_\_\_\_

Color: \_\_\_\_\_

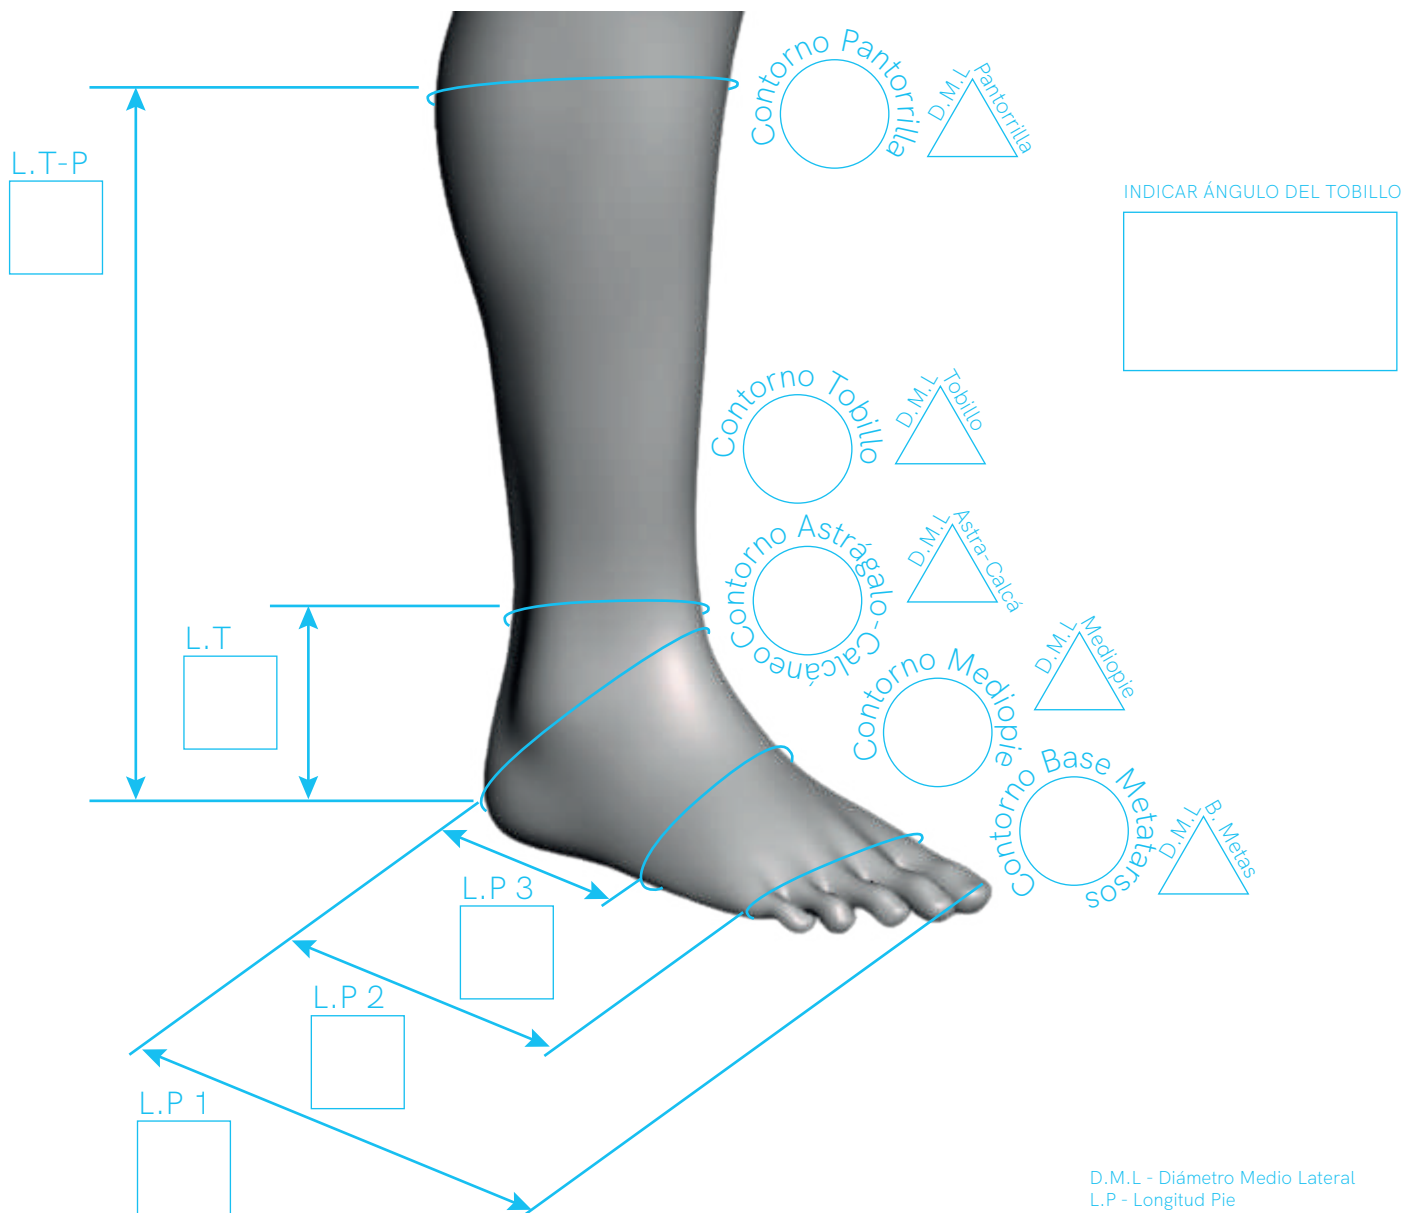

D.M.L - Diámetro Medio Lateral  
 L.P - Longitud Pie  
 L.T - Longitud Tobillo  
 L.T-P - Longitud Tobillo Pantorrilla

TIPO DE FÉRULAS Y CÓDIGOS



**FXT-OIC**  
Estabilizadora Tobillo



**FXT-OIL**  
Suropédica



**FXT-OIA**  
AFO



**FXT-PTB**  
PTB

Observaciones:

Comprueba que has realizado todos los pasos

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1º Escáner y iPad cargados       | <input type="checkbox"/> 5º Hoja de Medidas cumplimentada       |
| <input type="checkbox"/> 2º Escáner calibrado             | <input type="checkbox"/> 6º Fotos y vídeos tomadas              |
| <input type="checkbox"/> 3º Paciente en posición correcta | <input type="checkbox"/> 7º Información enviada                 |
| <input type="checkbox"/> 4º Escaneo correcto y enviado    | <input type="checkbox"/> 8º Confirmar que FIIXIT lo ha recibido |